

借通用件登记


描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

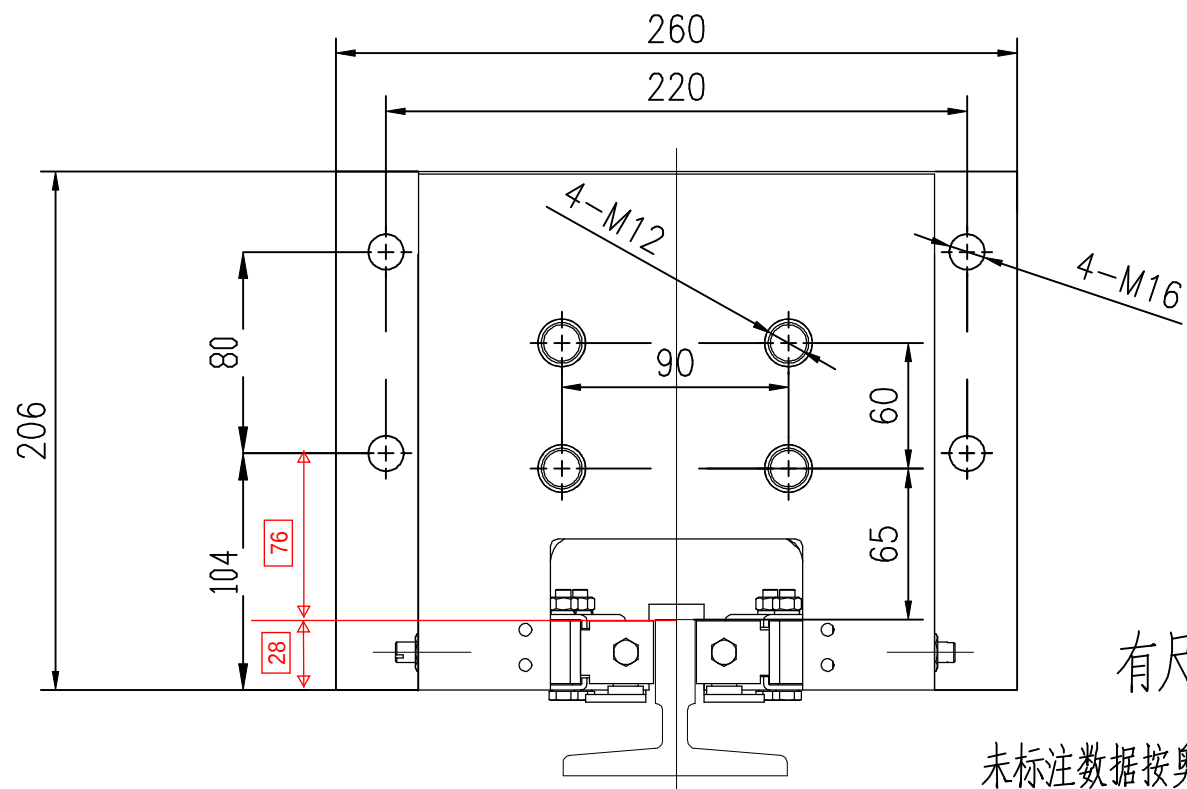

有尺寸要求请按本图纸制作

未标注数据按奥德普OX-188(G01)数据生产

~~P+Q=3300kg~~, 速度1.0m/s

配导轨厚度16mm 配OX-129导靴

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	周小勇	标准化	张松能	
校对	张云霞			
审核	潘峰			
工艺	印建明	日期		

合同号: 180222-A

杭州顺达伯耐特电梯有限公司

OX-188(G01)

杭州任远博康医院有限责任公司

图样标记

重量

比例

1:1

共 页

第 页